


新製品

PGT-Aバイオプシー専用 ホールディングピペット

コード KG-HDSB30

共同開発：医学博士 沖津 摂 先生

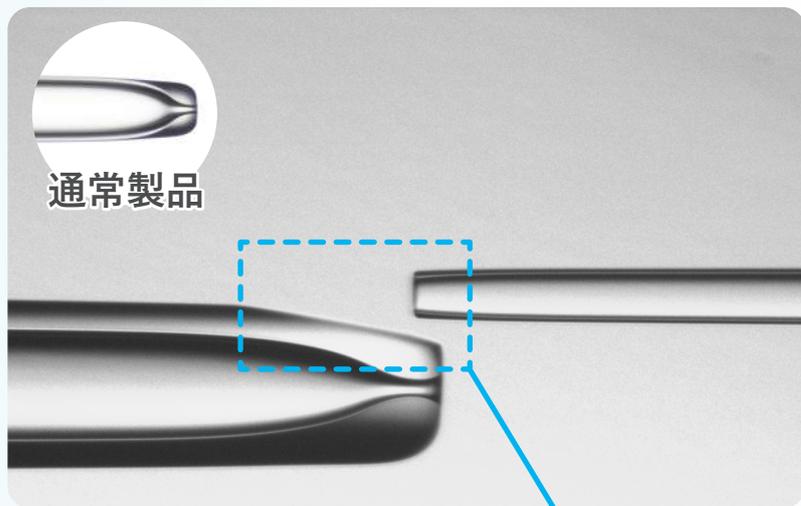


通常製品

ホールディングピペットの先端加工[※]による フリッキング操作への効果

- 👉 操作が簡単になります
- 👉 作業時間が短縮されます
- 👉 習得しやすく精度が向上します

※特許申請中

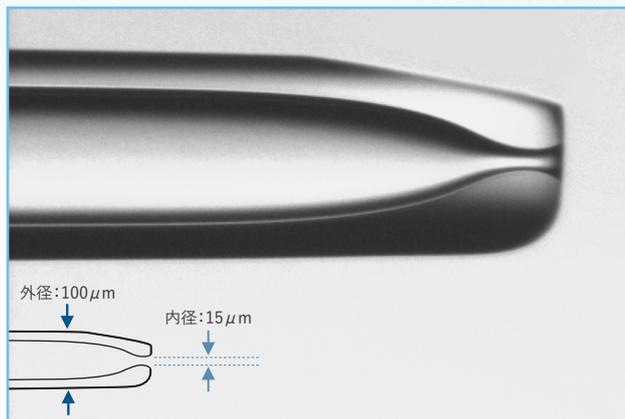


フリッキングの様子

右のQRコードを読み込むと
動画をご覧いただけます。



関連製品



バイオプシーピペット



各種試薬



PCRチューブスタンド

製品名	コード	内径	入数	
Biopsy Pipette	KG-BPS30	23-25μm	10本 / 箱	
製品名	コード	蓋色	内容量	入数
Biopsy Medium	KG-BPY	透明	1.5mL	5本 / 箱
PVP7%	KG-PVP07	緑	1.5mL	5本 / 箱
PVA1%	KG-PVA01	橙	1.5mL	5本 / 箱
PCR チューブスタンド	KG-TS01	-	-	2個 / 箱

ご注文、お見積りのご依頼は下記の北里検査センターにご連絡下さい。

株式会社 北里検査センター

〒105-0012

東京都港区芝大門一丁目1番8号



TEL 03-3434-2421

Mail info_biolab@kitazato.co.jp

HP www.kitazato-biolab.com

- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- 本書の内容を無断転載することはできません。
- Kitazatoロゴは、北里グループの登録商標です。
- 本製品は、日本国薬事法における医薬品・医療機器・医薬部外品ではございません。